
ATL051-TOL-1, CDCl3
1D1H.icon CDCl3 {C:\DATA\AJUPP\2022} AJupp 32

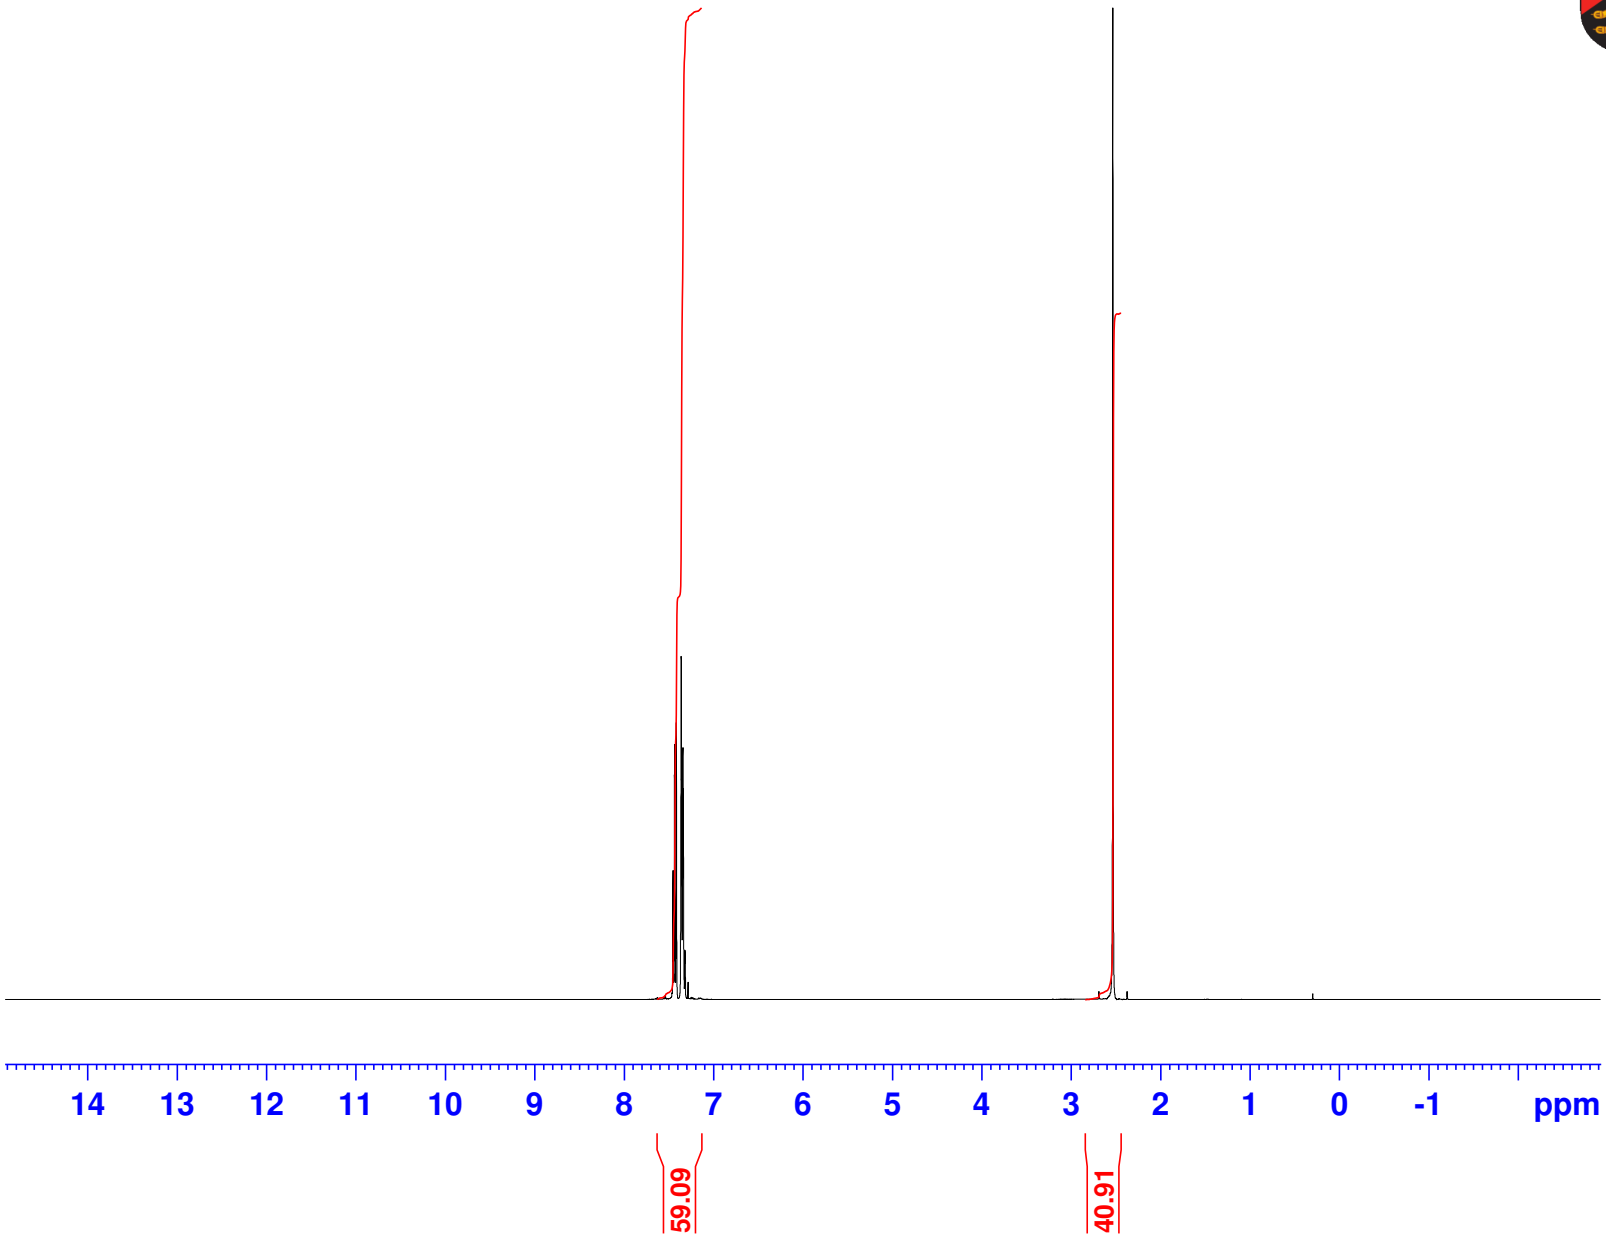


```
Current Data Parameters
NAME        ATL051-TOL-1
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20230516
Time              10.20 h
INSTRUM        AvanceNeo
PROBHD    Z116098_0793 (
PULPROG             zg30
TD                 65536
SOLVENT            CDCl3
NS                     4
DS                     0
SWH             7142.857 Hz
FIDRES          0.217983 Hz
AQ              4.5875201 sec
RG                    32
DW                70.000 usec
DE                 7.06 usec
TE                298.0 K
D1             2.00000000 sec
TD0                    1
SFO1         400.1324008 MHz
NUC1                  1H
P0                 3.30 usec
P1                 9.89 usec
PLW1         18.70000076 W

F2 - Processing parameters
SI                131072
SF          400.1300000 MHz
WDW                   EM
SSB                    0
LB                  0.10 Hz
GB                     0
PC                  1.00
```