

ATL051-TOL-1, CDCl3
1D_11B_1Hdec.icon CDCl3 {C:\DATA\AJUPP\2022} AJupp 32

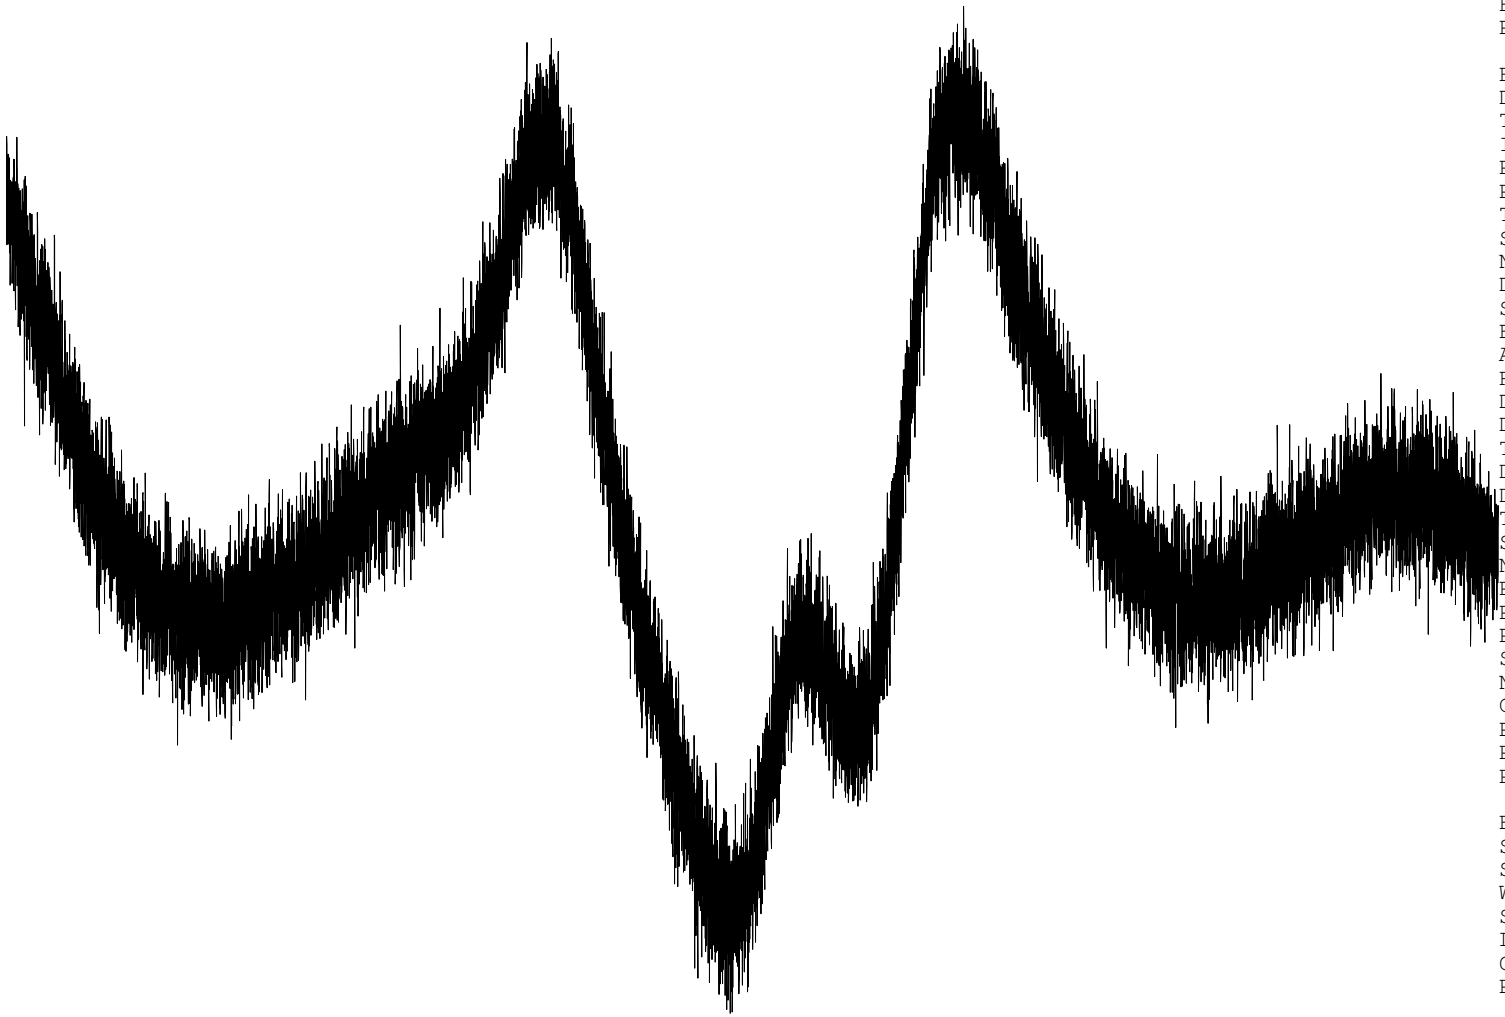



Current Data Parameters
NAME ATL051-TOL-1
EXPNO 13
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20230516
Time 10.34 h
INSTRUM AvanceNeo
PROBHD Z116098_0793 (
PULPROG zgig30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 200
DS 0
SWH 25906.736 Hz
FIDRES 0.790611 Hz
AQ 1.2648448 sec
RG 101
DW 19.300 usec
DE 6.50 usec
TE 298.0 K
D1 2.00000000 sec
D11 0.03000000 sec
TD0 1
SFO1 128.3776050 MHz
NUC1 11B
P0 2.97 usec
P1 8.90 usec
PLW1 80.00000000 W
SFO2 400.1300000 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz65
PCPD2 90.00 usec
PLW2 18.70000076 W
PLW12 0.22581001 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 128.3776050 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40