
1D_31P.icon CD2Cl2 {C:\DATA\TEACHING\2022} Teaching 25

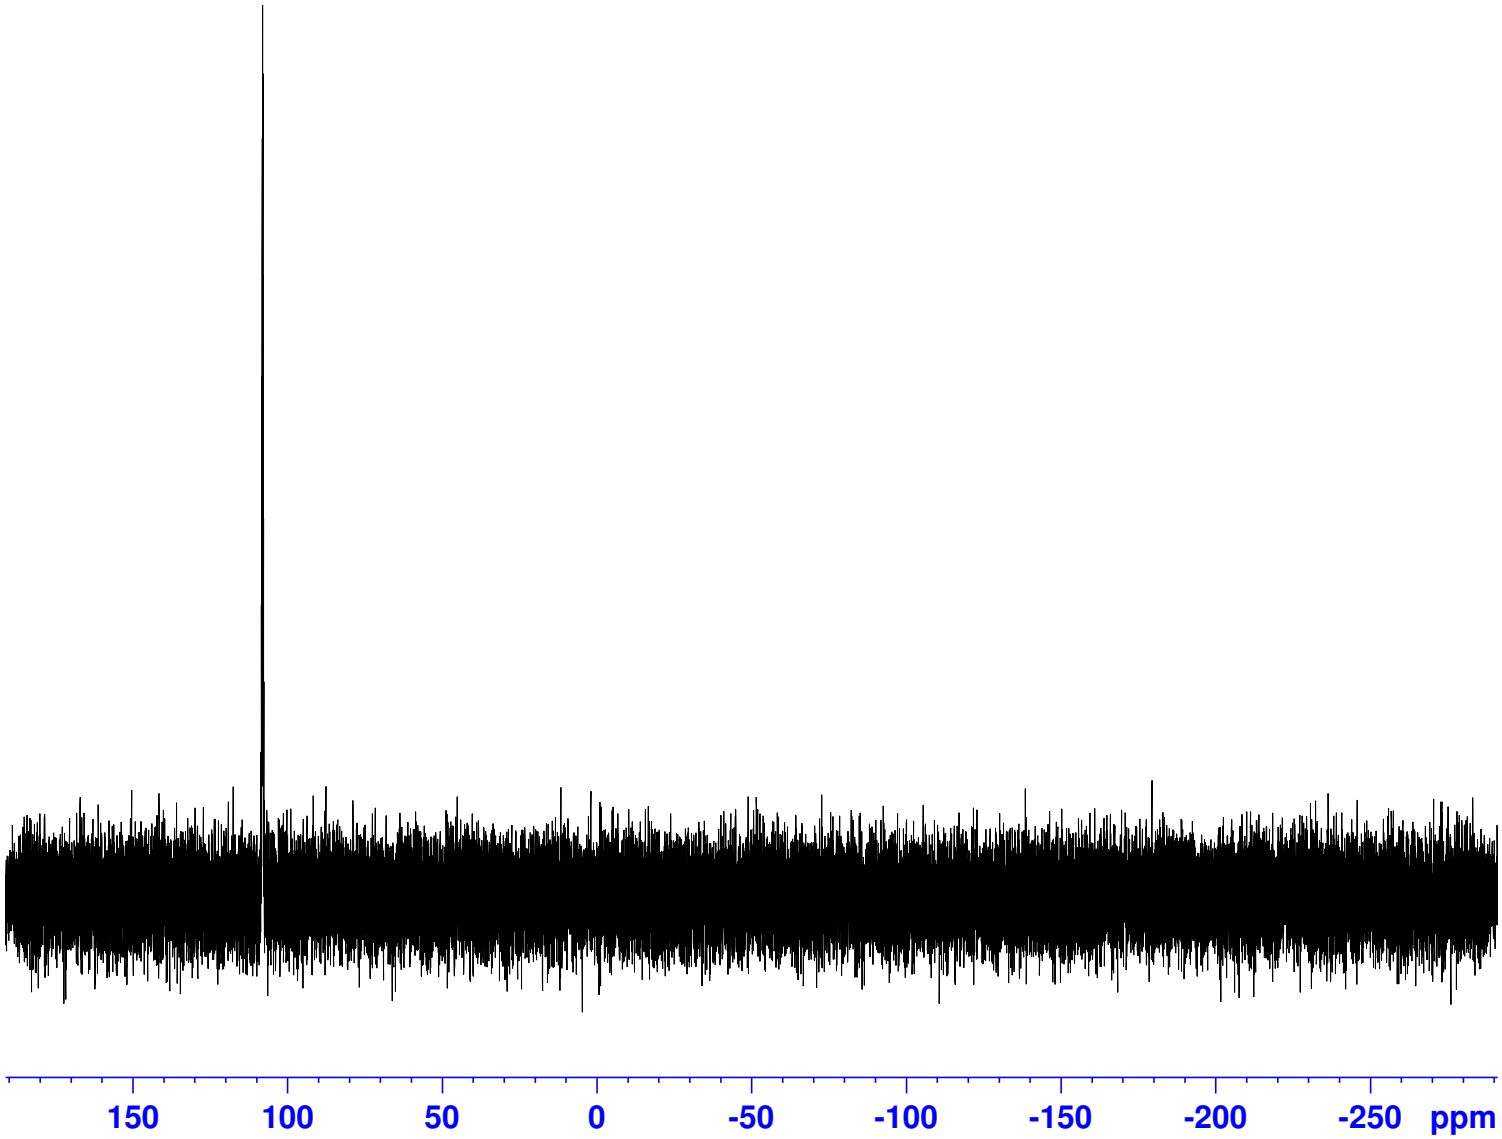

Current Data Parameters
NAME ET29_b
EXPNO 12
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20230302
Time 16.46 h
INSTRUM AvanceNeo
PROBHD Z116098_0793 (
PULPROG zg30
TD 163034
SOLVENT CD2Cl2
NS 200
DS 0
SWH 78125.000 Hz
FIDRES 0.958389 Hz
AQ 1.0434176 sec
RG 101
DW 6.400 usec
DE 6.64 usec
TE 298.0 K
D1 2.00000000 sec
TD0 1
SFO1 161.9674943 MHz
NUC1 31P
P0 2.67 usec
P1 8.00 usec
PLW1 61.14799881 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 161.9755930 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40