
1D_31P.icon CDCl3 {C:\DATA\TEACHING\2022} Teaching 22

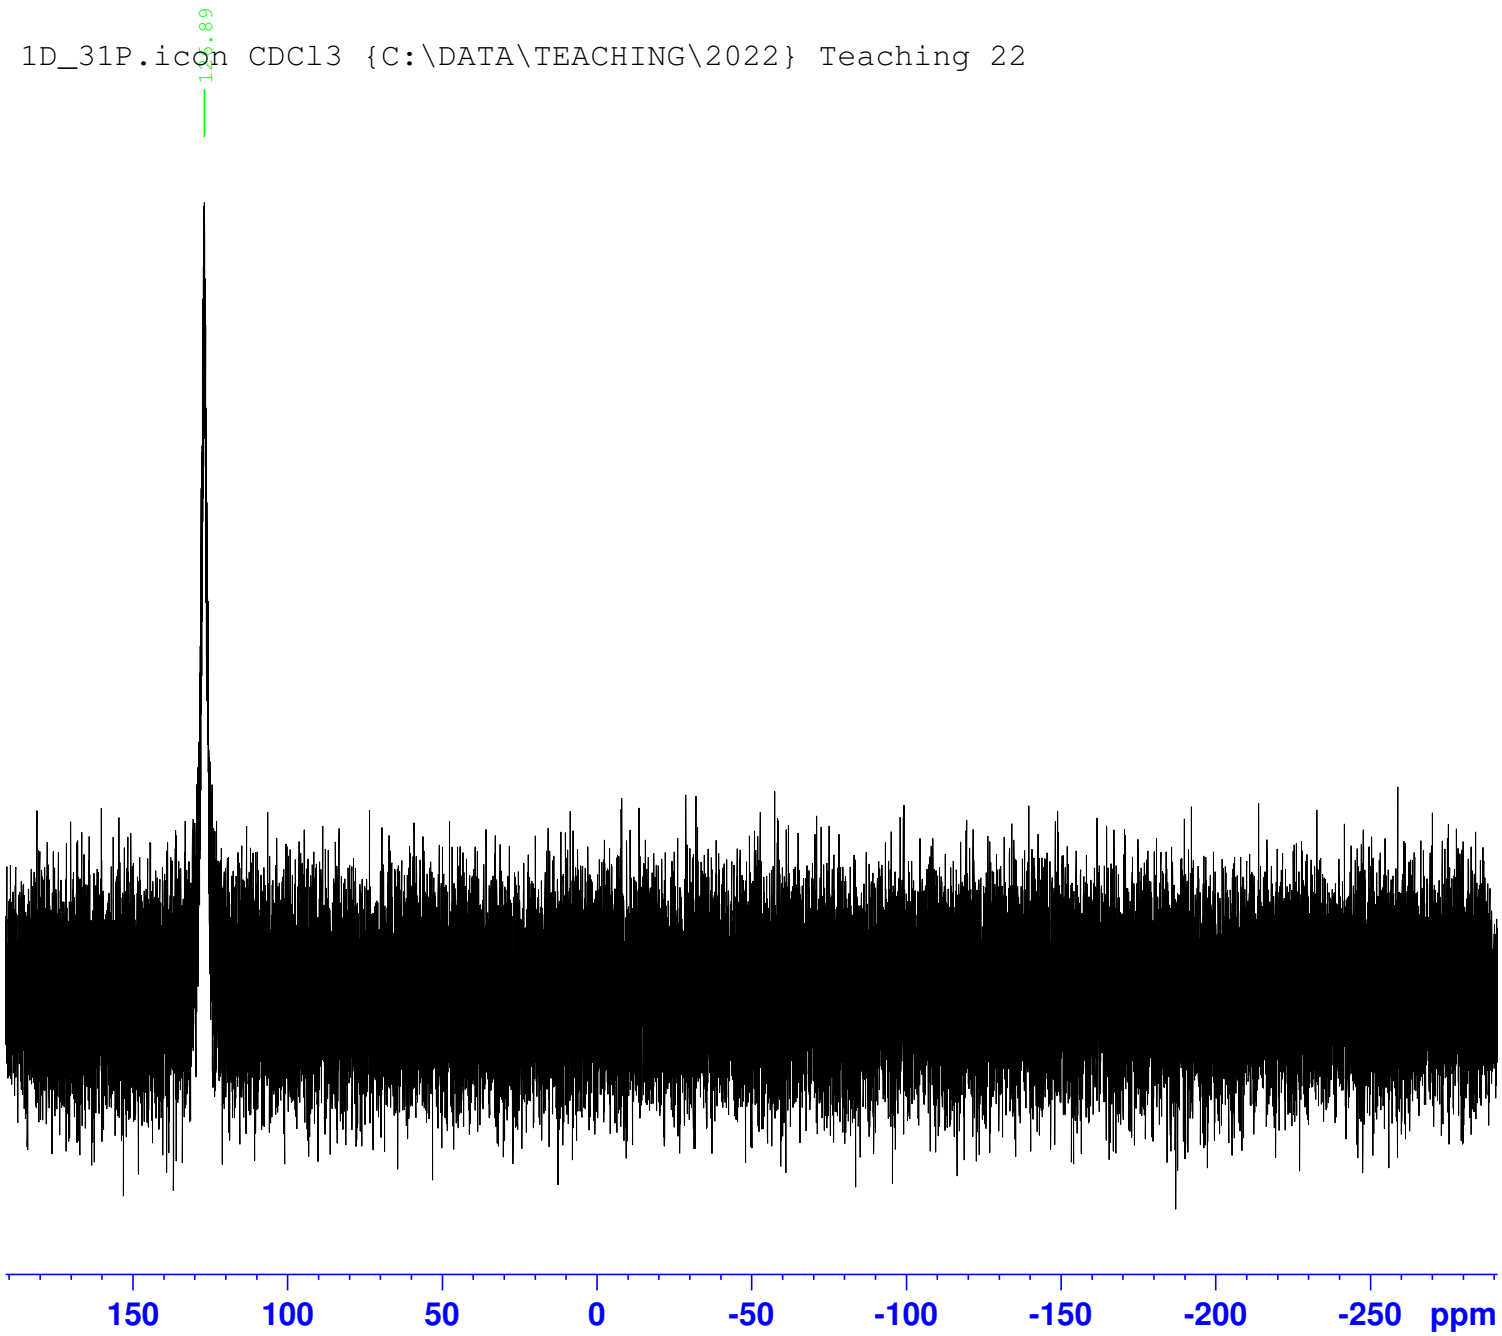

Current Data Parameters

NAME	ET16_full
EXPNO	15
PROCNO	1

F2 - Acquisition Parameters

Date_	20230225
Time	5.09 h
INSTRUM	AvanceNeo
PROBHD	Z116098_0793 (
PULPROG	zg30
TD	163034
SOLVENT	CDCl3
NS	200
DS	0
SWH	78125.000 Hz
FIDRES	0.958389 Hz
AQ	1.0434176 sec
RG	101
DW	6.400 usec
DE	6.64 usec
TE	298.0 K
D1	2.00000000 sec
TD0	1
SFO1	161.9674943 MHz
NUC1	31P
P0	2.67 usec
P1	8.00 usec
PLW1	61.14799881 W

F2 - Processing parameters

SI	65536
SF	161.9755930 MHz
WDW	EM
SSB	0
LB	1.00 Hz
GB	0
PC	1.40